








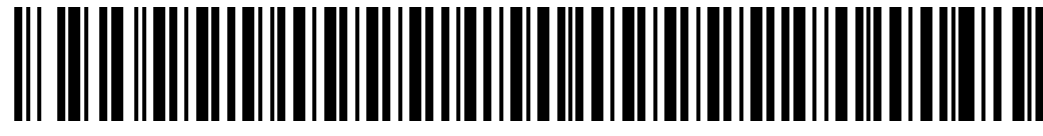
XN CHECK™ LT 表示値表



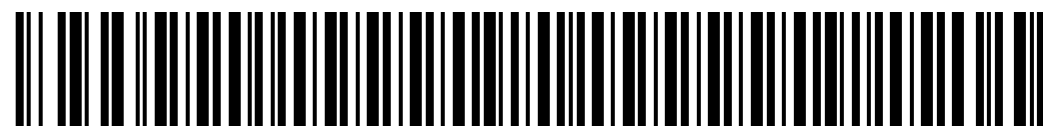

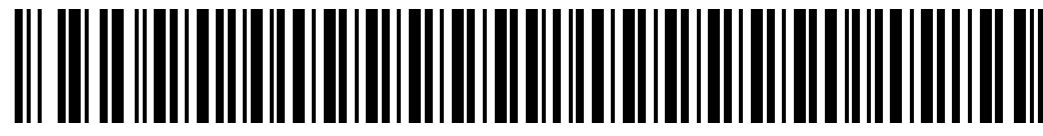


XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
83021101	

使用期限	
2019/01/20	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	236	12	
HGB	g/dL	6.1	0.3	
HCT	%	17.9	1.8	
MCV	fL	75.7	3.8	
MCH	pg	25.8	2.3	
MCHC	g/dL	34.1	5.1	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	9.5	7.6	
RDW-SD	fL	49.7	5.0	
RDW-CV	%	18.1	1.8	
PDW	fL	6.8	5.4	
PCT	%	0.08	0.09	
MPV	fL	9.0	9.0	
P-LCR	%	20.0	30.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。






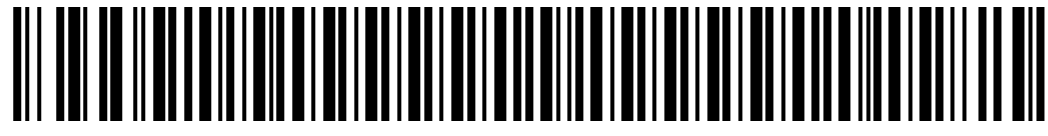
XN CHECK™ LT 表示値表

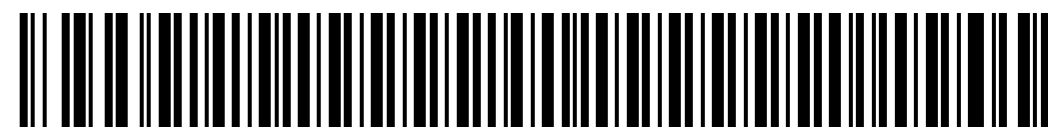


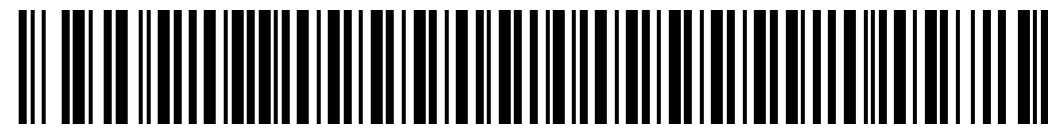
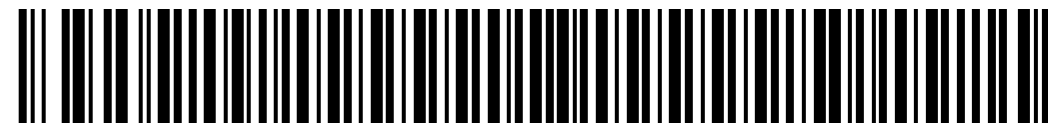
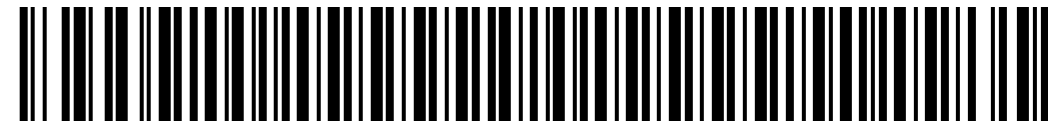
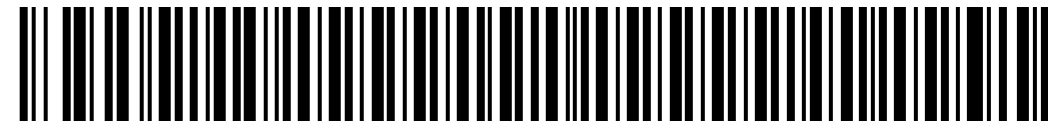
XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
83021101	

使用期限	
2019/01/20	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
WBC-C	10 ² /μL	32.0	3.2	
WBC-D	10 ² /μL	30.4	3.0	
NEUT#	10 ² /μL	11.9	2.4	
LYMPH#	10 ² /μL	10.8	4.3	
MONO#	10 ² /μL	3.1	2.5	
EO#	10 ² /μL	3.0	1.5	
BASO#	10 ² /μL	1.6	1.2	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
IG#	10 ² /μL	3.1	0.9	
NEUT%	%	39.2	7.8	
LYMPH%	%	35.5	14.2	
MONO%	%	10.3	8.2	
EO%	%	9.7	4.9	
BASO%	%	5.3	4.1	
IG%	%	10.2	3.1	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。